Translated by tccc.org.ua

CLS TCCC | CMC TCCC | CPP TCCC

COMBAT LIFESAVER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

ЗУПИНКА ВУЗЛОВОЇ ПАХОВОЇ КРОВОТЕЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМПРОВІЗОВАНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТИСКУ (ПСТ)

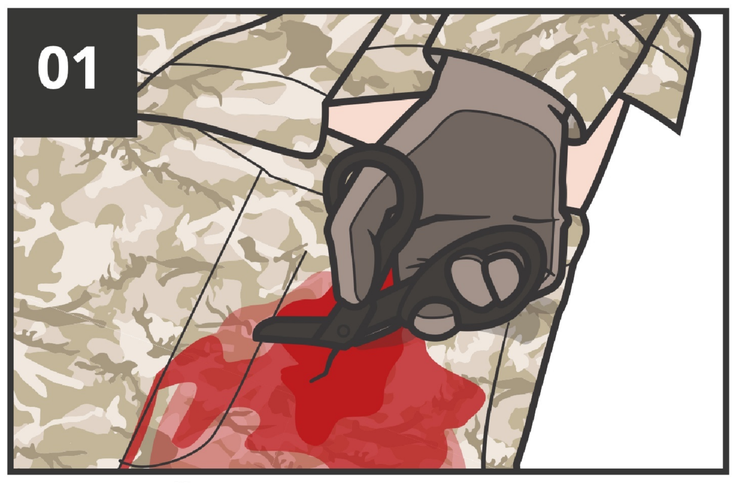

РОЗКРИЙТЕ місце поранення та огляньте джерело кровотечі.

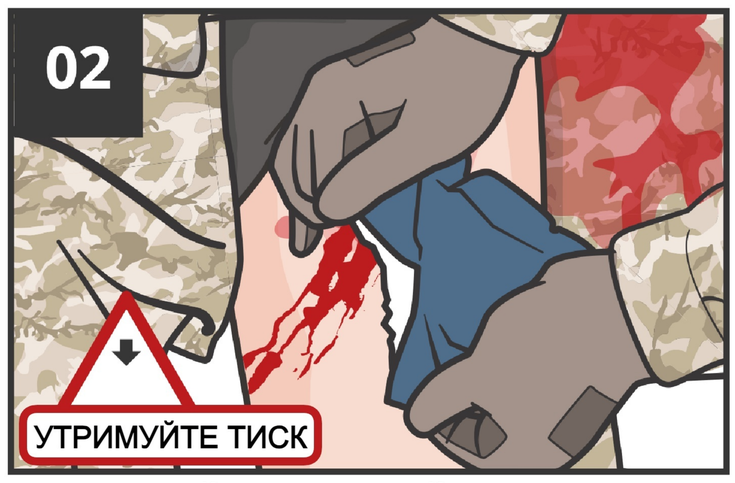

ЗАСТОСУЙТЕ ПРЯМИЙ ТИСК на рану, використовуючи свою долоню, кулак або лікоть, та відкрийте упакування з гемостатичним бинтом.

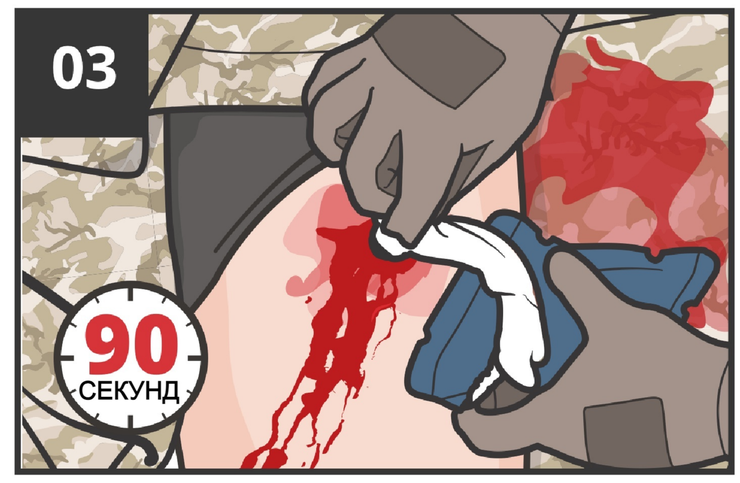

Виконайте ЩІЛЬНЕ ТАМПОНУВАННЯ рани гемостатичним бинтом до заповнення всієї порожнини рани (завершуючи тампонування в межах 90 сек).

УТРИМУЙТЕ тиск впродовж мінімум 3 хв.

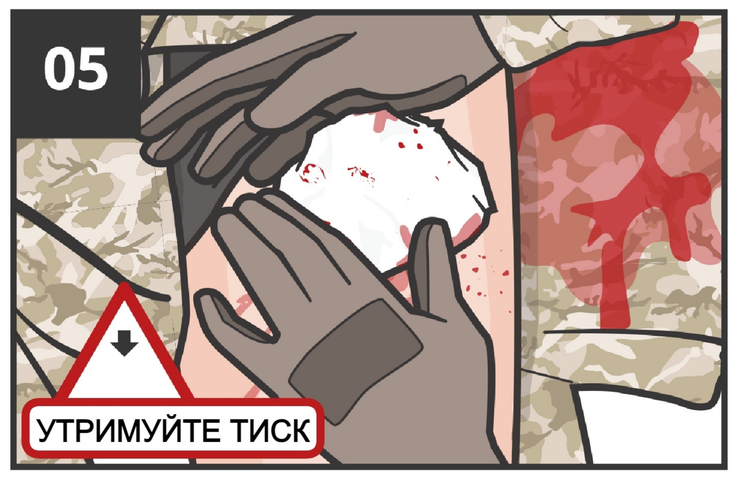

ПОВТОРНО ОЦІНІТЬ, чи зупинено кровотечу, одночасно утримуючи тиск.

ЯКЩО КРОВОТЕЧА НЕ БУЛА ЗУПИНЕНА:

06.1 Якщо використано гемостатичний бинт – вийміть його та проведіть повторне тампонування новим гемостатичним бинтом, починаючи від КРОКУ 3.

АБО

06.2 Якщо використано звичайний бинт - додайте ще один бинт і утримуйте тиск на рану (впродовж ще 3 хв), поки кровотеча не зупиниться.

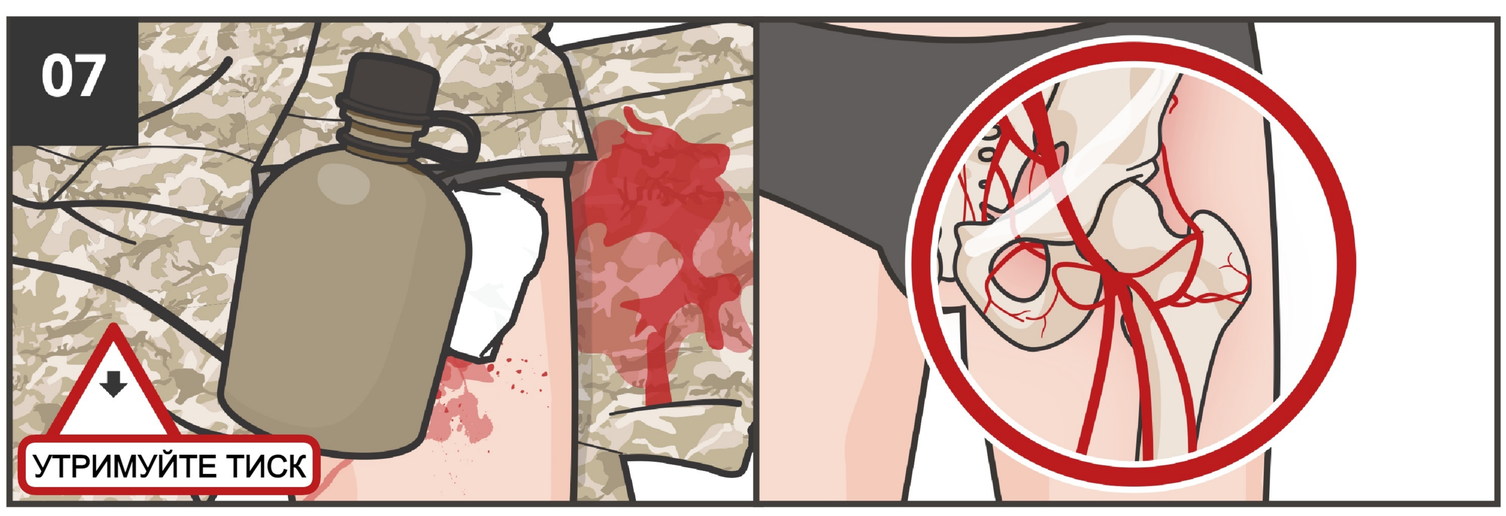

ВИБЕРІТЬ пристрій для створення тиску (ПСТ) та розташуйте його в ділянці пахової складки, одночасно підтримуючи тиск.

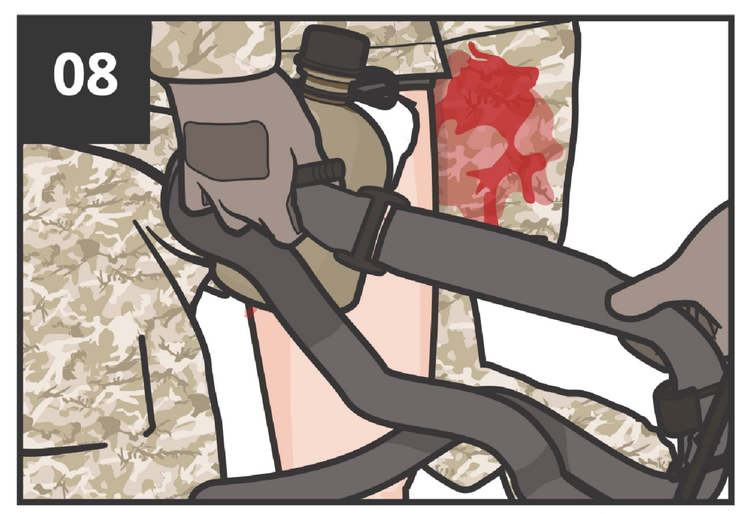

ОБЕРІТЬ турнікет, який можна буде обернути навколо талії/стегна пораненого, або з’єднайте разом два турнікети.

Продовження на наступній сторінці…

Translated by tccc.org.ua

ЗУПИНКА ВУЗЛОВОЇ ПАХОВОЇ КРОВОТЕЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМПРОВІЗОВАНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТИСКУ (ПСТ)

Продовження…

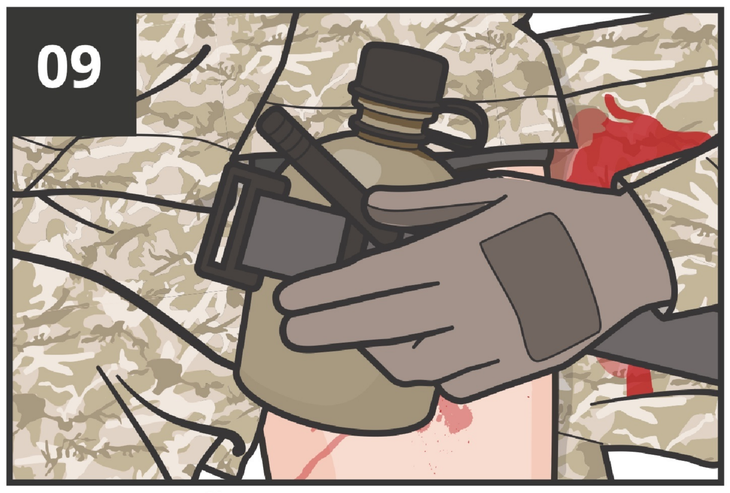

РОЗТАШУЙТЕ турнікет із зубчастим механізмом або турнікет з воротком і пряжкою безпосередньо над серединою ПСТ; упевніться, що зубчастий механізм/вороток розташований у напрямку досередини тіла.

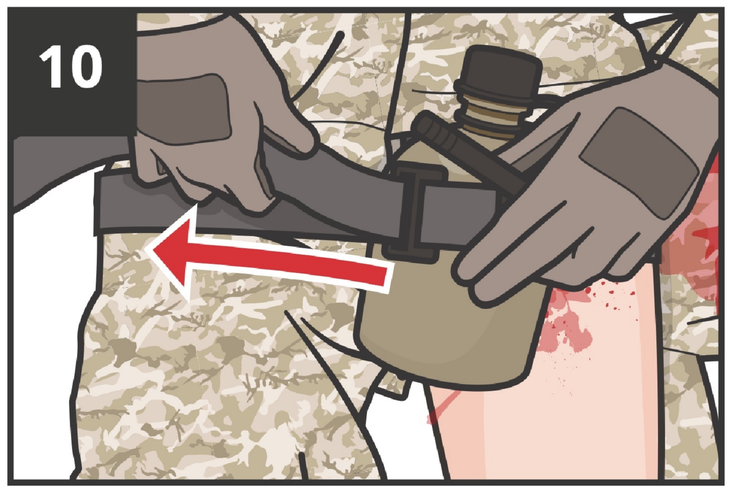

Перед затягуванням турнікета УСУНЬТЕ всі провисання ременя/самоклейкої стрічки, виконуючи штовхаючі рухи впоперек тіла пораненого.

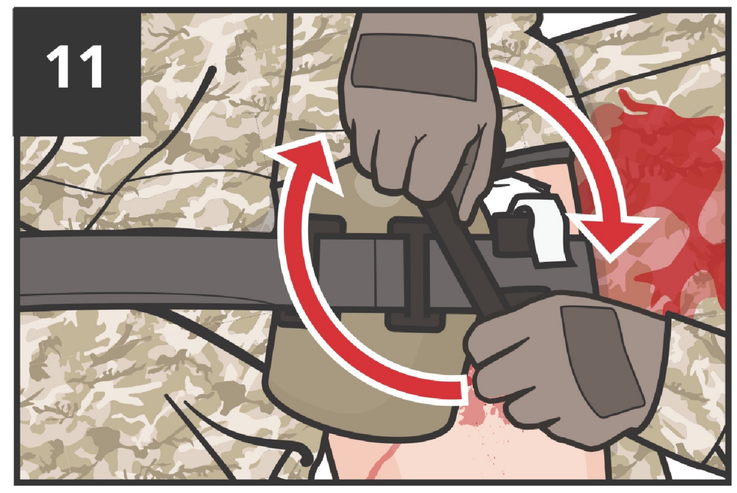

ЗАТЯГНІТЬ турнікет до припинення кровотечі та зникнення дистального пульсу на кінцівці.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 11: Якщо кровотеча не зупинилася та не зник дистальний пульс нижче накладання турнікета, усуньте всі залишкові провисання ременя (якщо це можливо) і сильніше закрутіть вороток або затягніть зубчастий механізм турнікета, доки кровотечу не буде зупинено та доки не зникне дистальний пульс.

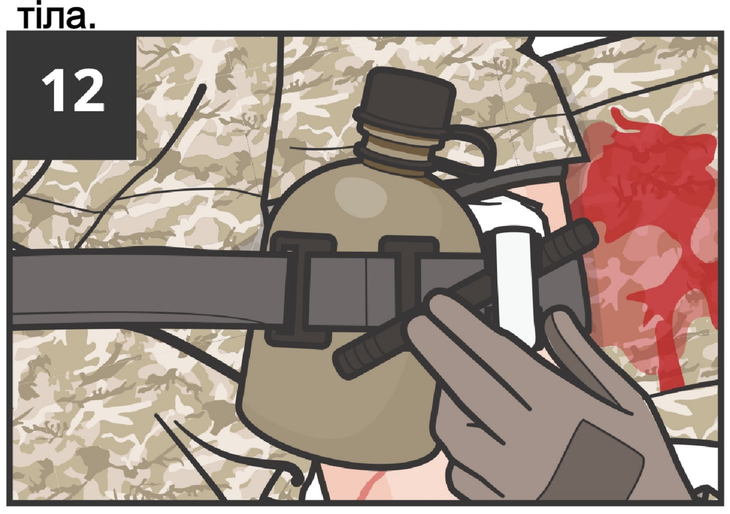

ОГЛЯНЬТЕ розташування обладнання та переконайтеся, що ПСТ не змістився, а зубчастий механізм/вороток і пряжка знаходяться в належній позиції над пристроєм.

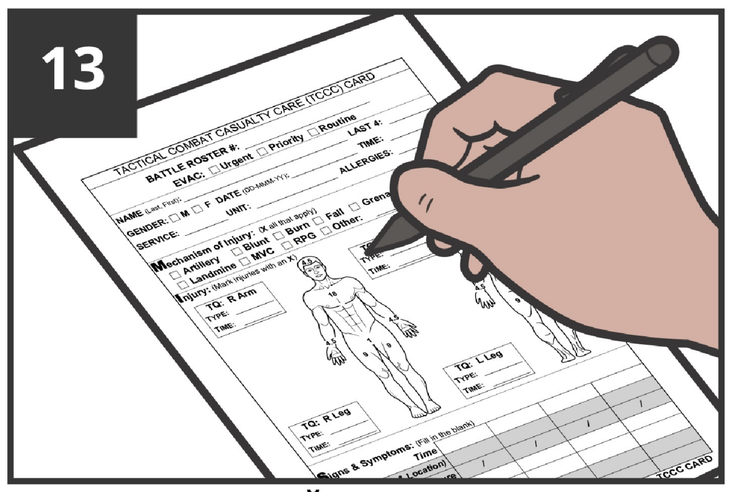

ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.