ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН

ПРИМІТКА: Пристрій для закриття ран можна використовувати в поєднанні з іншими методами зупинки кровотечі, а саме:

1. Тампонування рани : Якщо необхідно, тампонування рани може бути виконане до того, як на рану буде накладено пристрій для закриття ран.
2. Гемостатичні засоби : пристрій для закриття ран можна накладати на рану, яка була попередньо тампонована кровоспинним засобом. Гемостатичний засіб в такому випадку виймати не потрібно.
3. Перев'язка або бандаж : за бажанням можна накласти додатковий компресійний бандаж чи пов'язку на пристрій для закриття ран після його накладання на рану. Це захистить пристрій і зможе забезпечити додатковий тиск на рану, зменшуючи ймовірність утворення гематоми.

ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.
ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

УВАГА: Не використовуйте в ділянці очей.

01 РОЗКРИЙТЕ місце поранення та огляньте джерело кровотечі.
ПРИМІТКА: Можливо, вам буде потрібно зрізати одяг, щоб належним чином відкрити доступ до рани.

02 Якщо можливо, ЗАСТОСУЙТЕ ПРЯМИЙ ТИСК на джерело найбільш активної кровотечі.

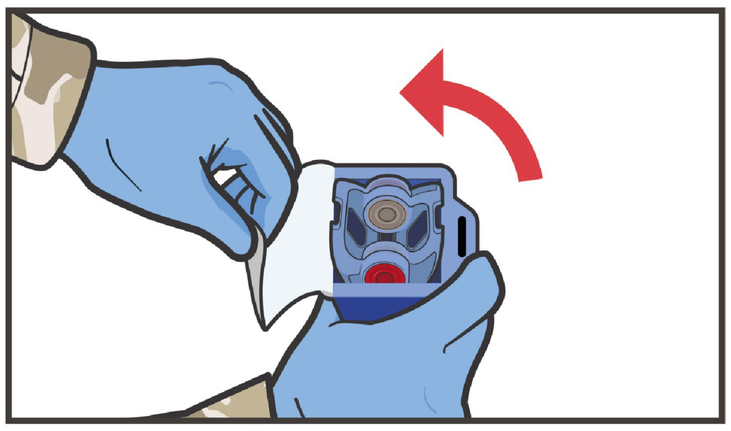

03 ВІДКРИЙТЕ стерильну упаковку, відклеївши один або обидва краї на верхній частині упаковки.

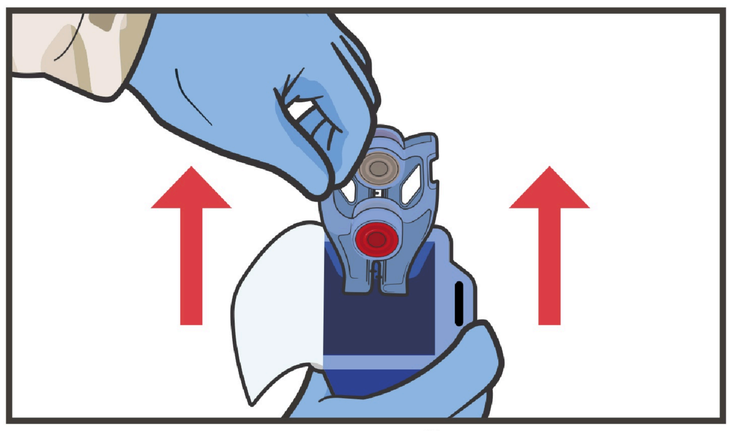

04 Однією рукою ВИЙМІТЬ пристрій для закриття ран з упаковки, піднявши його прямо вверх.

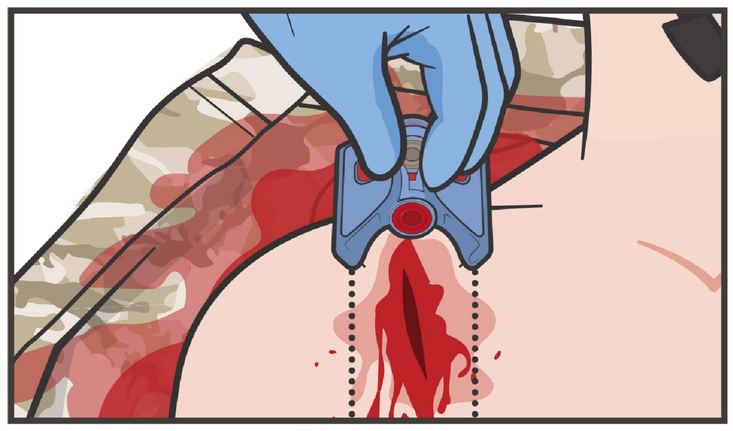

05 РОЗТАШУЙТЕ кінці голок пристрою для закриття ран паралельно (вздовж) країв рани.

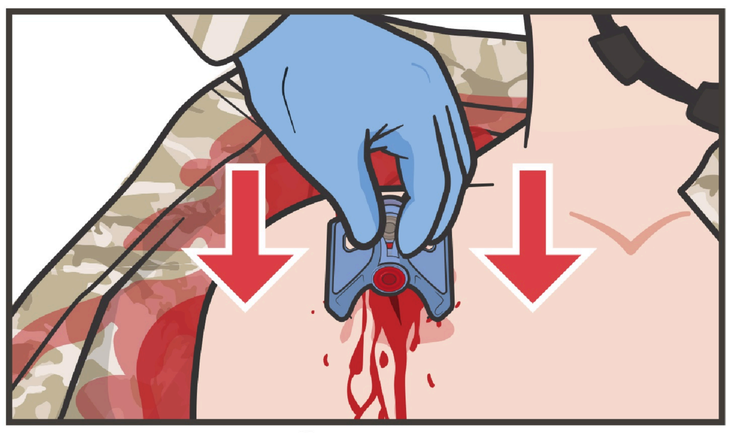

06 РОЗТАШУЙТЕ голки приблизно на відстані 1-2 см від країв рани з обох боків.

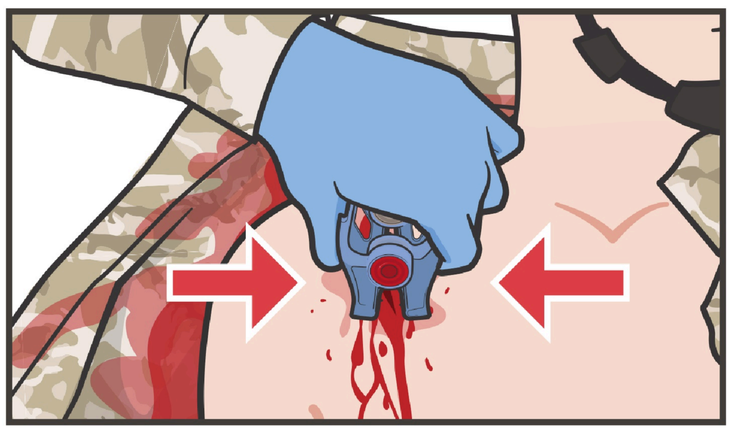

07 АКУРАТНО ВСТАВТЕ голки і закрийте пристрій, стиснувши його ручки та наблизивши їх одна до одної.

ПРИМІТКА: Пломба пристрою зруйнується одразу ж після стискання його ручок.

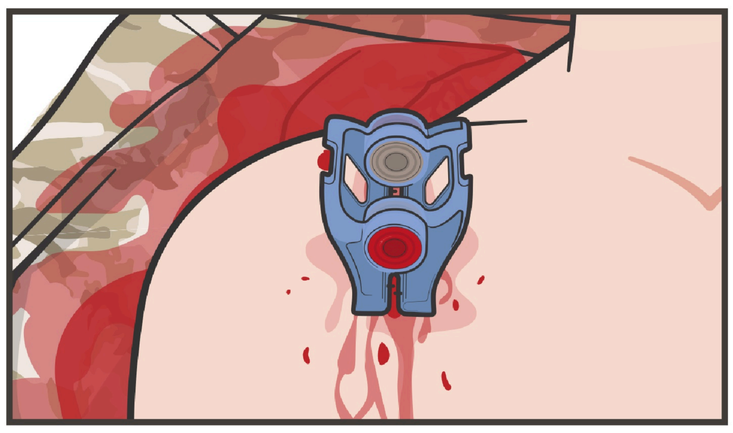

08 ПІСЛЯ ЗАКРИТТЯ пристрій автоматично заблокується на місці (ручки пристрою забезпечать непроникне для рідини закриття рани).

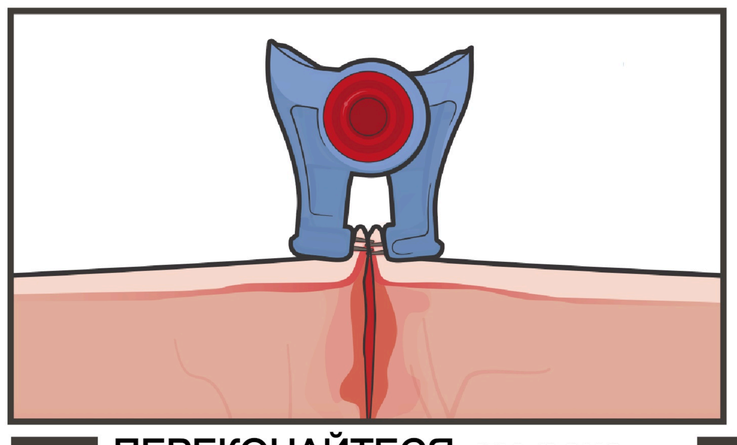

09 ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що рана щільно закрита, на шкірі немає проміжків, а кровотеча не продовжується.

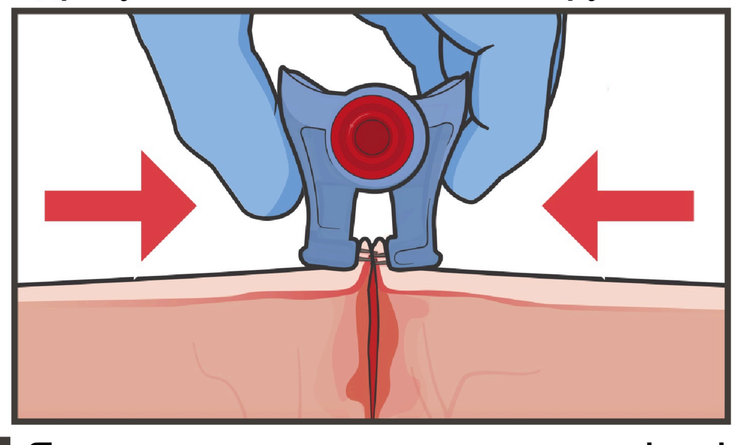

10 Якщо кровотеча продовжується: щільніше ЗАФІКСУЙТЕ пристрій; зніміть його, поміняйте розташування і повторно накладіть пристрій; застосуйте більше, ніж один пристрій; або затампонуйте рану гемостатичним бинтом чи XSTAT®, а потім повторно накладіть пристрій.

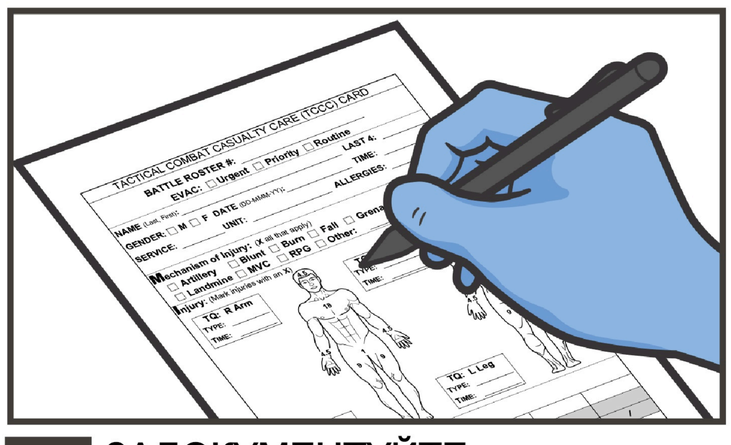

11 ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН

Як знімати…

ПРИМІТКА: Щоб відкрити пристрій для закриття ран, потрібно використати кнопки розблокування з обох боків пристрою.

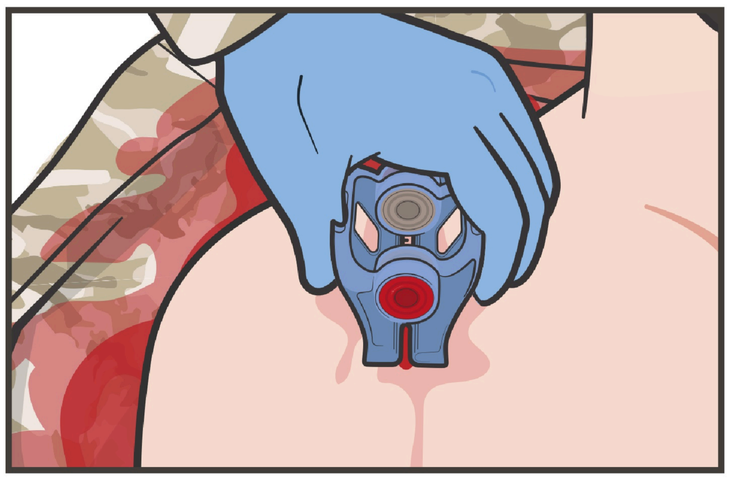

01 ВІЗЬМІТЬСЯ за верхні ручки пристрою однією рукою.

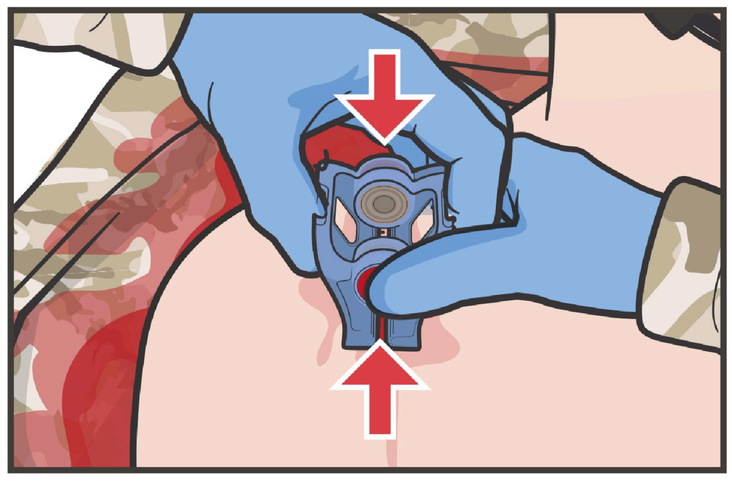

02 НАТИСНІТЬ на червоні кнопки з боків затискача, щоб розблокувати замикаючий механізм, потім стисніть верхні ручки пристрою разом, щоб відкрити його.

ПРИМІТКА: Цей процес виконується за допомогою двох рук.

ПРИМІТКА: Тримайте пристрій за кнопки під час зняття, аби мінімізувати випадковий контакт з голками.

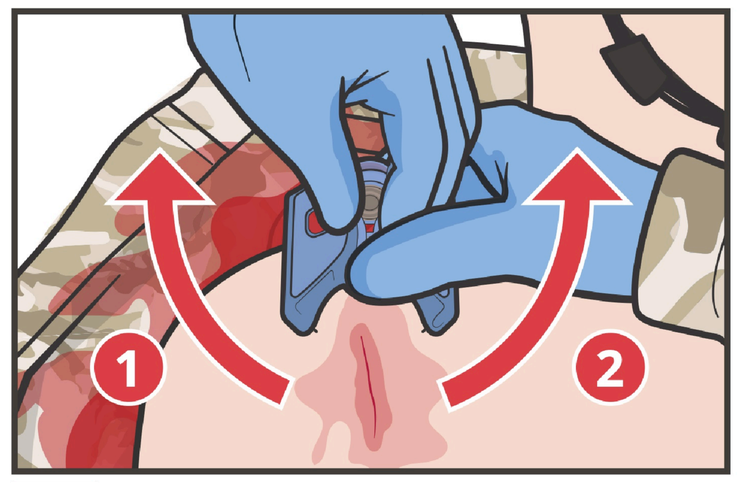

03 Утримуючи натиск на кнопки, ПІДНІМІТЬ один край затискача і ВИТЯГНІТЬ голки з одного краю рани. Потім витягніть голки з іншого боку рани. Одночасно можна витягнути голки лише з одного боку.

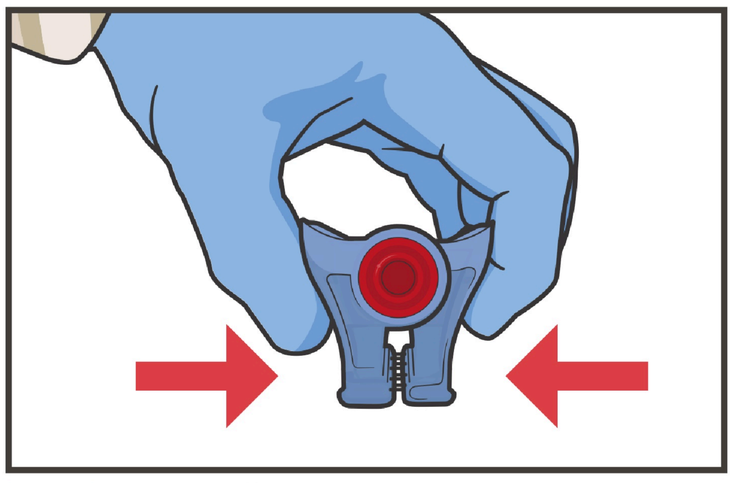

04 ЗАКРИЙТЕ пристрій, стиснувши нижні ручки до повного закриття, щоб запобігти випадковому пораненню його голками.

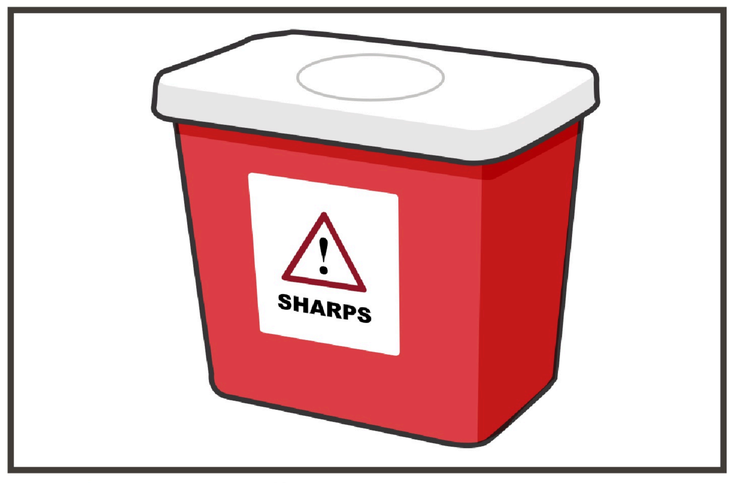

05 УТИЛІЗУЙТЕ пристрій відповідно до місцевих інструкцій щодо біологічно небезпечних гострих предметів.

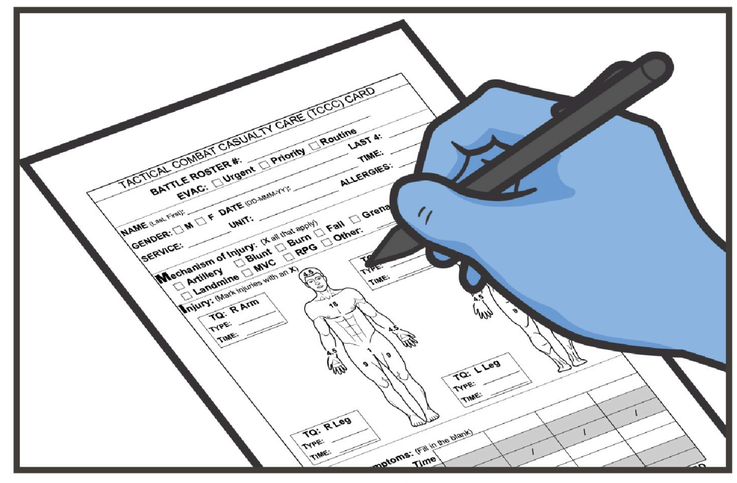

06 ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.

УВАГА: Небезпечний гострий предмет – поводьтеся обережно, щоб уникнути травм.